

設置チェックシート(ひずみ・水位データ集録装置 NetLG-301N) 1/2

地点		実施日	年	月	日	実施者		天候	
----	--	-----	---	---	---	-----	--	----	--

【集録装置】

型 式	NetLG-301N		
製 造 番 号 No.			
ROMバージョン	()
製 造 年 月	年		月

【機器基本設定】

ネットワークアドレス	#	増設ユニット	<input type="radio"/> 有	<input type="radio"/> 無	
水位記録インターバル			認識	<input type="checkbox"/>	
インターバル6時間以上の記録時刻		電 源	ch総数	ch	
ひずみ記録インターバル	インターバル6時間以上の記録時刻		外部	V	
			電池	メイン	サブ
			V	V	
		内部温度	°C		
		時計確認	<input type="checkbox"/>		
		ノイズフィルタ	50 / 60 Hz		

【水位センサ】

型 式	DS-1	m計	m付
製 造 番 号 No.			
製 造 年 月	年		月

【観測】 半自動(機器単独) 通信機接続 無線機→通信機接続

パイプ方向線	山側 / 谷側
--------	---------

水位セットアップ

センサ係数	オフセット	m	センサ深度	GL-m	地表面標高	EL.m
-------	-------	---	-------	------	-------	------

転送データ 実水位のみ 地下水位のみ 標高水位のみ 実水位&地下水位 実水位&標高水位

ひずみセットアップ

ひずみ初期値時刻 設定 無 有 時刻 ひずみデータ極性反転 ON OFF

水位警報設定

	監視項目	警報値	ヒステリシス値	アラート	
				番号	宛先
警報 1	上限 / 下限	m	m	#	#
警報 2	上限 / 下限	m	m	#	#
警報 3	上限 / 下限	m	m	#	#
警報 4	上限 / 下限	m	m	#	#

ひずみ警報設定

警報無効ch() (○…有効 ×…無効)

	監視項目	警報値	ヒステリシス値	アラート		経時時間
				番号	宛先	
警報 1	経時 / 累積	μS	μS	#	#	
警報 2	経時 / 累積	μS	μS	#	#	
警報 3	経時 / 累積	μS	μS	#	#	
警報 4	累積	μS	μS	#	#	

※警報4は累積変動のみ


警報接点	A / B
ON 時間	

地点名: _____

- ① 地下水位 GL-m

- ② 実水位 m

- ③ センサ深度 GL-m
- 立上り m
- 孔長 m

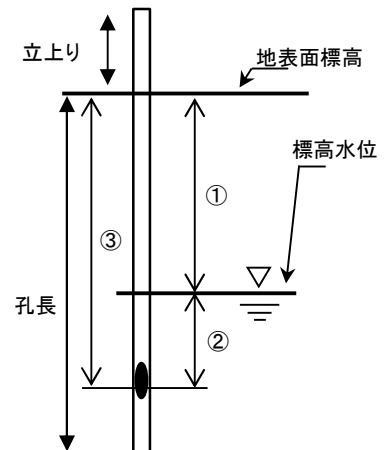

記録開始時刻		時	分
開始時	地下水位	GL-m	
データ	手測り	GL-m	

※ひずみ: 2/2ひずみデータ開始時刻欄に記入

設置チェックシート(ひずみ・水位データ集録装置 NetLG-301N) 2/2

地点	
----	--

データロガー製造番号 No. _____

ひずみ抵抗値、データ(オフセット) 内部抵抗値(赤-白、黒-白間で差異が大きい場合は赤-黒間も測定すること)

ch	内部抵抗値		絶縁抵抗値	オフセット	開始時(初期値) データ	備考
	赤-白	黒-白	白-アース			
1	Ω	Ω	MΩ		μS	
2	Ω	Ω	MΩ		μS	
3	Ω	Ω	MΩ		μS	
4	Ω	Ω	MΩ		μS	
5	Ω	Ω	MΩ		μS	
6	Ω	Ω	MΩ		μS	
7	Ω	Ω	MΩ		μS	
8	Ω	Ω	MΩ		μS	
9	Ω	Ω	MΩ		μS	
10	Ω	Ω	MΩ		μS	
11	Ω	Ω	MΩ		μS	
12	Ω	Ω	MΩ		μS	
13	Ω	Ω	MΩ		μS	
14	Ω	Ω	MΩ		μS	
15	Ω	Ω	MΩ		μS	
16	Ω	Ω	MΩ		μS	
17	Ω	Ω	MΩ		μS	
18	Ω	Ω	MΩ		μS	
19	Ω	Ω	MΩ		μS	
20	Ω	Ω	MΩ		μS	
21	Ω	Ω	MΩ		μS	
22	Ω	Ω	MΩ		μS	
23	Ω	Ω	MΩ		μS	
24	Ω	Ω	MΩ		μS	
25	Ω	Ω	MΩ		μS	
26	Ω	Ω	MΩ		μS	
27	Ω	Ω	MΩ		μS	
28	Ω	Ω	MΩ		μS	
29	Ω	Ω	MΩ		μS	
30	Ω	Ω	MΩ		μS	

備考
